

ДОГОВОР № 62

за изпълнение на: „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция № 8, Доставка на кардиостимулатори за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД”

Номенклатурна/и единица/и № 105,106,107,118,119,120,121,122,123,130,131

№ на процедурата на РОП: 00499-2017-0006

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

Днес, 04.10.2017 г., в гр.Хасково между:

“Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. “Съединение” №49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„**БУЛМЕД 2000**” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1680, район „Красно село”, кв. ”Бели брези”, ул. ”Хайдушка гора” №59-61, ЕИК 121268853, представлявано от Людмил Борисов Първанов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

на основание чл. 112, ал. 6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД”, определени подробно по вид и цени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълнява поръчката при условията на приетата от Възложителя оферта на Изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е “МБАЛ – Хасково” АД с адрес: гр.Хасково 6300, бул.“Съединение” № 49 – франко скалд болнична аптека.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.2.Срок на договора - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му.

Чл.3. (1) Срок за доставка – доставката на медицинските изделия се извършва в срок *до 8 часа при спешност и до 24 часа*, след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.

(2) В случай, че Изпълнителят не достави заявения продукт в посочения по ал.1 срок и това се случи повече от три пъти, договорът може да се прекрати едностранно от Възложителя, без предизвестие, по отношение на съответната обособена позиция/номенклатура.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4.(1) Общата стойност на договора е 810 808.70 (осемстотин и десет хиляди осемстотин и осем лева и 0.70 стотинки) лв, без ДДС / 972 970.40 (деветстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и седемдесет лева) лв, с ДДС.

(2) Единичните цени на изделията не могат да бъдат променяни в срока на действие на настоящия договор, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(3) Цената е окончателна и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на предмета на поръчката.

(4) В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението ѝ, определени в настоящия договор, Възложителят се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

(5) За количества, доставени извън заявените, Възложителя, не дължи плащане.

(6) Плащанията се извършват с платежно нареждане в български лева в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура-оригинал, по банкова сметка на Изпълнителя.

(7) Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на договора и по отделните заявки.

Чл.5 При отказ, било то писмен или мълчалив, от страна на Изпълнителя за доставка на продукт/и, предмет на договора или в случаите по чл.3, ал.2 от настоящия договор, Възложителят има пълното право да закупи продукта/ите, упоменати в заявката, за която е направен отказа, от друго място (друг доставчик), като разликата в цената може да се удържи от гаранцията за изпълнение на договора или чрез прихващане на дължими суми.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 8 108,09 лева, представляващи 1% (един процент) от общата стойност на договора без ДДС.

(2) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на договора.

(4) Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл.7. Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията за изпълнение на договора.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. Възложителят се задължава:

1. да заплати стойността на доставените изделия в сроковете и при условията на настоящия договор, след представяне на фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
2. да прегледа изделията при получаването им и, ако има възражения, да уведоми незабавно Изпълнителя.
3. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.9. Възложителят има право:

1. да получи изделията в срока и на мястото, посочени в договора;
2. когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговарят изделията, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора.

РАЗДЕЛ VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10.(1) Изпълнителят се задължава:

1. да осигурява необходимите количества изделия, предмет на договора, за целия срок на неговото действие;
2. на свой риск да доставя и предава на Възложителя медицинските изделия в оригинална опаковка и с ненарушена цялост;
3. да доставя изделията в договорения срок и да ги предава придружени с необходимата документация за качество и произход;
4. да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.11. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.12. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.13. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.4 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VIII. ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.14. За предаването и приемането на стоката, предмет на договора, се съставя приемо-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощени представители на двете страни.

Чл.15. Рекламации по количествата на доставките могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.16. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 5 (пет) дневен срок от откриването им.

Чл.17. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ IX. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 19 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна с подписването на двустранен констативен протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 20. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. С изтичане на срока.

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

3. При наличие на основание по чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки без писмено предизвестие;

4. При прекратяване на дейността, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на която и да било от страните.

5. При констатирани системни нарушения и/или конфликт на интереси, с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя. За целите на настоящия договор системно нарушение е всяко виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, извършено повече от три поредни пъти - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. Забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 2 /два/ дни.
2. Не отстрани в срок констатирани недостатъци, установени от Възложителя.
3. Извърши доставка в несъответствие с условията на този договор, повече от два пъти.
4. По реда на чл.3, ал.2 от настоящия договор.

(3) Възложителят може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя доставки.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 22. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско законодателство.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора.

(3) При забавено изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) на ден от договорената цена по настоящия договор, но не повече от 10% (десет на сто) от нейния размер.

(4) В случай, че Изпълнителят преустанови виновно изпълнението на възложената работа, същият дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на останалата неизпълнена работа.

(5) Ако извършеното по настоящия договор не отговаря изцяло на неговия предмет или на указанията на Възложителя, или е изпълнено толкова лошо, или съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, Възложителят има право да откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора.

Чл.23. В случай, че Възложителят прекрати договора поради възникнали непредвидени обстоятелства, вследствие на които не е в състояние да изпълни своите задължения, то същият не дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

XIV. СПОРОВЕ

Чл. 24. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

Чл.25. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл.27. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 28. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл.30 Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл.31. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Чл. 32. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

1. Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;

2. Приложение № 2 – Ценово предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД

Д-р ГЕОРГИ ГЕЛОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕ
НА „БУЛМЕ

МИЛ ПЪРВАНОВ

Съгласувано с:

Главен счетоводител:

Юриконсулт:

Замитена
фармацевт
от 2 от 33 АД

салисена шифор-
на 001
от 33 АД

Наименование на участника:	„Булмед 2000“ ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези“, ул. „Хайдушка“ гр. 59-61
ЕНК:	121268853
Точен адрес за кореспонденция:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези“, ул. „Хайдушка“ гр. 59-61
Телефонен номер:	02/9580481;02/9580482;02/9580483;02/9580484
Факс номер:	02/9580192
Лице за контакт:	Людмил Борисов Първанов
e-mail:	marketing@bulmed2000-bg.com

до „МБАЛ - Хасково“ АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

*„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на
инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково“ АД“*

Обособена позиция № 8, „Кардиостимулатори“

(изписва се № и наименованието на обособената позиция)



Номенклатурна/и единица/и № 105; 106; 107; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 130; 131

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението
документацията за участие условия със следното ценово предложение:

Цена в лева без / с ДДС, съгласно Приложение № 3.


Приложение:

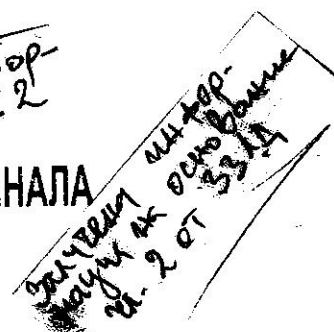

Ценово предложение: Приложение № 3 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.

Така предложената от Нас *цена* включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Дата	05/06/2017г.
Име и фамилия	Людмил Първанов
Подпис на лицето (и печат)

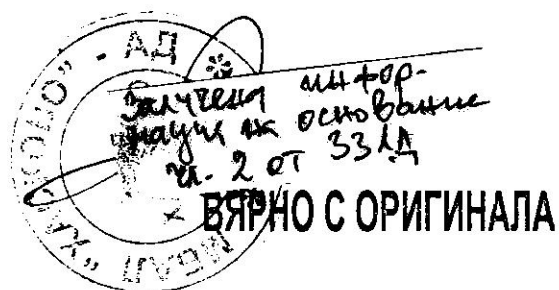

ЛОЖЕН №3

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 20.07.2011
 10.2011
 10.2011
 10.2011

ВИД	ОПИСАНИЕ	Количество за 24 месеца в брой	ПРОИЗВОДИТЕЛ	ДЪРЖАВА ПРОИЗВОДИТЕЛ	количество в опаковката предназначено за продажба	Каталожни № и № на страницата от каталога/проспекта	Цена без ДДС за едница мярка (бр.)	Цена с ДДС за едница мярка (бр.)	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с ДДС
Кардиостимулатор VVIR в комплект с електрод с пасивна фиксация	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - КАРДИОСТИМУЛАТОРИ Еднокухнен кардиостимулатор VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Програмируемо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполусно. Позволява частично излагане на ЯМР 12 watts per kg. Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция + биполярен електрод с пасивна фиксация, Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на електрода: Стероид-елуиран - количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпламенение в чуждото тяло. Optim изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. Препоръчителен размер на интродюсера 7 F. Прав	50	St. Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия +1 бр. в кутия	Endurity Core SR1152+is oflex 1948 58cm. Стр. 34 и стр.44	1990.00	2388.00	99500.00	119400.00

НО С ОРИГИНАЛ

Кордиостимулатор VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която е адаптирана при промяна в прага на стимулация. Програмируемо чване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система е максимално адаптирана на прага на безопасност за пациента с ждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана автоматично или дуплолюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години.

Кордиостимулатор VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която е адаптирана при промяна в прага на стимулация. Програмируемо чване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система е максимално адаптирана на прага на безопасност за пациента с ждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана автоматично или дуплолюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години.

Кордиостимулатор VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която е адаптирана при промяна в прага на стимулация. Програмируемо чване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система е максимално адаптирана на прага на безопасност за пациента с ждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана автоматично или дуплолюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години.

16	Кордиостимулатор VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която е адаптирана при промяна в прага на стимулация. Програмируемо чване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система е максимално адаптирана на прага на безопасност за пациента с ждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана автоматично или дуплолюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години.	50	St. Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия +1 бр. в кутия	Endurity Core SR1152+T endr11 STS 2088 58cm. Стр. 34 и стр.48	1991.67	2390.00	99583.50	119900.00
17	Кордиостимулатор VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която е адаптирана при промяна в прага на стимулация. Програмируемо чване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система е максимално адаптирана на прага на безопасност за пациента с ждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана автоматично или дуплолюсно. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години.	20	St. Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия	Endurity Core SR1152 Стр.34	1939.17	2327.00	38783.40	46540.08
18	Двукухнен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симпатични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4cc. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция	30	St. Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия	Endurity Core DR2152 Стр.14	1923.34	2308.00	57700.20	69240.00



<p>Двукухинни кардиостимулатори DDR</p> <p>Двукухинни кардиостимулатори DDR</p> <p>комплект с електроди с пасивна фиксация</p>	<p>Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4cc. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция. + биполярен електрод с пасивна фиксация. Optm изолация, IS-1 съвместим. ендокардиален, биполярен. електрод.Обща характеристика на електрода:Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез инициране на локално възпаление в чуждото тяло Optm изолация Fast-Pass обвивкаПасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав + биполярен електрод с пасивна фиксация. Optm изолация. IS-1 съвместим. ендокардиален, биполярен. електрод.Обща характеристика на електрода Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез инициране на локално възпаление в чуждото тяло. Optm изолация. Fast-Pass обвивка. Пасивна фиксация. J тип</p>	<p>20</p>	<p>St.Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия+1 бр. в кутия+1 бр. в кутия</p>	<p>Endurity Core DR2152 +Isoflex 1948 58cm.+Isoflex 1944 52cm.Стр. 14 и стр.44</p>	<p>1926.67</p>	<p>2312.00</p>	<p>38333.40</p>	<p>41240.08</p>
--	--	-----------	----------------------------	------------	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------



<p>Двукухнен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксисмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР (2 watts per kg). Обем 10.4cc. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9 години потвърдена от 5 годишна гаранция. + Биполярен електрод с пасивна фиксация. Optim изолация. IS-1 съвместим. ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на електрода: * Стероид-еулиран - количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е предвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез инициране на локално възпаление в чуждото тяло. * Optim изолация: Fast-Pass обвивка- Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав + Биполярен, стероид-еулиран, активно фиксиран имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомогатщо за излъчване на спиралата, за по-сигурно заковане. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа моноплично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fг. Външен диаметър 1.9 мм. Разстоянието от върха до пръстена мм. Прав електрод Дължини: 46, 52, 58, 65, 100 см</p>	<p>100</p>	<p>St Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия+1 бр. в кутия+1 бр. в кутия</p>	<p>Endurity Core DR2152 +Isoflex 1948 58cm.+Te ndrill 2088 52cm. Стр. 14, стр. 44 и стр. 48</p>	<p>1990.83</p>	<p>2389.00</p>	<p>199083.00</p>	<p>238900.00</p>
<p>Двукухнен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксисмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР (2 watts per kg). Обем 10.4cc. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9 години потвърдена от 5 годишна гаранция. + Биполярен, стероид-еулиран, активно фиксиран имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомогатщо за излъчване на спиралата, за по-сигурно заковане. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа моноплично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fг. Външен диаметър 1.9 мм. Разстоянието от върха до пръстена мм. Прав електрод Дължини: 46, 52, 58, 65, 100 см</p>	<p>50</p>	<p>St. Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия+1 бр. в кутия+1 бр. в кутия</p>	<p>Endurity Core DR2152 +Tendrill 2088 58cm.+Te ndrill 2088 52cm. Стр. 14 и стр. 48</p>	<p>1926.67</p>	<p>2312.00</p>	<p>96333.50</p>	<p>115600.00</p>

ВЯР

Handwritten notes and stamps, including a circular stamp with text: "ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР 1.9 мм", "ДЪЛЖИНИ: 46, 52, 58, 65, 100 см", "ПРАВ ЕЛЕКТРОД".

Двукухинни кардиостимулатори VDDR, в комплект с един VDD електрод	Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симпатични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция+Билоларен ендокардиален електрод с пасивна фиксация. Прав, изолация от силикон; Разстояние между връх вентрикулен пръстен 15мм; връх-атриален пръстен 130мм; разстояние между атриалните пръстени 11.9 мм; връх от микропорест титаниев нитрид с обвивка платина-иридий 5мм2; Размер на интродюсера 9F; Пръстен от титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий 32мм2	50	St.Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутията 1 бр. в кутия	Endurity Core DR2152 + AV Plus 1368 Стр. 14 и стр. 24	2000.00	2400.00	100000.00	120000.00
Двукухинни кардиостимулатори VDDR	Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг Технология за редуциране на камерното пейсиране Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация Алгоритъм за подтискане на симпатични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима ЯМР съвместим Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/ Обем 10.4сс Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция	20	St.Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия	Endurity Core DR2152 Стр. 14	1925.00	2310.00	38500.00	46200.00
Loop Recorder	Използва се за мониторинг и диагностика на пациенти с ритъмни нарушения Предимството на тази система е , че това е най - малкото устройство от този тип /12гр/. Има ръчно и автоматично активиране. Три години живот на устройството. При изследване с ЯМР времето на облъчване не трябва да надвишава 60мин	10	St.Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия	Confirm 2102 Стр. 28	1939.17	2327.00	19391.70	23270.00
Интродюсери тип Peel Away	Интродюсера се характеризира с добра транзитност, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка Вътрешен диаметър на интродюсера от 6 F до 12 F, използваема дължина на интродюсера 14 cm, максимален диаметър на водеща 0.038"	500	St.Jude Medical	САЩ	5 бр. в кутия	Peel Away 4051xx Стр. 54	46.80	56.16	23400.00	28080.00

Дата: 05.06.2017г.
 Име и фамилия Людмил Първанов
 Подпис на лицето (и печат)
 С ОРИГИНАЛА
 Записан митоп-
 Пробен на септ. 2017г.
 от 331А

Наименование на участника:	„Булмед 2000“ ЕООД
Седанце и адрес на управление по регистрация:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези“, ул. „Хайдушка гора“ 59-61
ЕИК:	121268853
Точен адрес за кореспонденция:	пк. 1680, гр. София, кв. „Бели Брези“, ул. „Хайдушка гора“ 59-61
Телефонен номер:	02/9580481;02/9580482;02/9580483;02/9580484
Факс номер:	02/9580192
Лице за контакти:	Людмил Борисов Първанов
e-mail:	marketing@bulmed2000-bg.com

до „МБАЛ - Хасково“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПО
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:
**„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на
инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково“ АД“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации:

Доставката на медицинските изделия ще извършваме в срок до 24 (Двадесет и четири) часа при спешност и до 8 (Осем) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя.

**Забележка: Възложителят определя максимален срок за доставка на медицинските изделия по всички обособени позиции: до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.*

Залучена информация

основание

гл. 2 от ЗЗПА

Заложена информация
на осн. № 2
от 33 АА

Заложена информация
на осн. № 2
от 33 АА

Декларираме, че към момента на доставяне, медицинските изделия, предмет на обществената поръчка ще бъдат в срок на годност. Остатъчният срок на годност ще бъде 75% (Седемдесет и пет) процента от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

***Забележка:** Възложителят определя Остатъчният срок на годност на медицинските изделия по всички обособени позиции да бъде не по-малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

3. Декларираме, че ще осигурим *необходимите количества* (медицински изделия / консумативи) за срока на действие на договора, в случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка.

4. Предлагащите от нас продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от настоящата документация.

Заложена информация
на осн. № 2
от 33 АА

Приложение:

Техническо предложение: Приложение № 2 на хартиен и оптичен носител - CD или DVD.

Дата	05/ 06/ 2017г.
Име и фамилия	Людмил Първанов
Подпис на лицето (и печат)

Заложена информация
на осн. № 2
от 33 АА

МБАЛ "ХИТО" ПЛОВДИВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заложена информация
на осн. № 2
от 33 АА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Данните са информирани на стр. в. 2 от 33 А

ЧУВСТВО
- 2000
- 2000
- 2000

	<p>Обособена позиция № 8 - КАРДИОСТИМУЛАТОРИ</p>		<p>Еднокухнен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Програмируемо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно. Позволява частично излагане на ЯМР 1/2 watts per kg/ Обем 9.7cc. Тегло 19gr. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция + биполярен електрод с пасивна фиксация, Орбит изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на електрода. * Стероид-еулиран - количество по-малко от 1 милиграм на декаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е придвижено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпадение в чуждото тяло. * Орбит изолация. * Fast-Pass обвивка. * Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав</p>	<p>50</p>	<p>St. Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия +1 бр. в кутия</p> <p>Endurity Core SR1152+Tendril 1948 58cm. Стр.34 и стр.44</p>
<p>105</p>	<p>Еднокухнен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Програмируемо превключване на поляризацията. ЯМР съвместим. Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно. Позволява частично излагане на ЯМР 1/2 watts per kg/ Обем 9.7cc. Тегло 19gr. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция + Биполярен, стероид-еулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с декаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fг. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. Прав електрод. Дължина- 46, 52, 58, 65, 100 см</p>	<p>50</p>	<p>St. Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия +1 бр. в кутия</p> <p>Endurity Core SR1152+Tendril STS 2088 58cm. Стр.34 и стр.48</p>		

Данните са информирани на стр. в. 2 от 33 А

ЧУВСТВО
- 2000
- 2000
- 2000

ВАЖНО С ОРЪГИНАЛА

107	<p>Кардиостимулатор VVIR</p> <p>Двукухинни кардиостимулатори DDDR</p>	<p>20</p> <p>St. Jude Medical</p> <p>САЩ</p> <p>1 бр. в кутия</p> <p>Endurity Core SR1152 Стр. 34</p>	<p>20</p> <p>St. Jude Medical</p> <p>САЩ</p> <p>1 бр. в кутия+1 бр. в кутия+1 бр. в кутия</p> <p>Endurity Core DR2152 + Isoflex 1948 58cm. + Isoflex 1944 52cm. Стр.14, Стр.44</p>
118	<p>Двукухинни кардиостимулатори DDD-R</p>	<p>30</p> <p>St. Jude Medical</p> <p>САЩ</p>	<p>20</p> <p>St. Jude Medical</p> <p>САЩ</p>
119	<p>Двукухинни кардиостимулатори DDDR комплекс с електроди с пасивна фиксация</p>	<p>20</p> <p>St. Jude Medical</p> <p>САЩ</p>	<p>20</p> <p>St. Jude Medical</p> <p>САЩ</p>

нояризацията. ЯМР съвместим. Пейсирещата система предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или двуполносно. Позволява частично излагане на ЯМР 1/2 watts per kg/ Обем 9.7cc. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсиреща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР 1/2 watts per kg/ Обем 10.4cc. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсиреща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР 1/2 watts per kg/ Обем 10.4cc. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция. + биполярен електрод с пасивна фиксация, Optm изоляция, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на електрода: Стероид-елуиран - количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optm изоляция Fast-Pass обвивка Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав + биполярен електрод с пасивна фиксация, Optm изоляция, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод Обща характеристика на електрода: Стероид-елуиран - количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optm изоляция Fast-Pass обвивка Пасивна фиксация. J тип

4433 10

4433 10

ВЪРХО С ОБРАТНА

118

119

119

<p>съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР (2 watts per kg). Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция. + Биполярен електрод с пасивна фиксация, Optm изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика на електрода: * Стероид-еулиран - количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. * Optm изолация * Fast-Pass обвивка * Пасивна фиксация Препоръчителен размер на интродюсера 7 F Прав + Биполярен, стероид-еулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за излъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Хлъзгаво покритие, което улеснява преминаването му през интродюсера и вените. Изолация от химически ко- полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - съдържжа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегирано с дексаметазон натриев фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fг. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние от върха до пръстена 10 мм. Прав електрод. Дължини- 46, 52, 58, 65, 100 см</p>	<p>100</p>	<p>St. Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия+1 бр. в кутия+1 бр. в кутия</p> <p>Endurity Core DR2152 + Isoflex 1948 58cm.+Tendril 2088 52cm. Стр.14 стр.44 и стр.48</p>
<p>Двукухинни кардиостимулатори DDDR комплект с електрод с пасивна и активна фиксация</p> <p>Закотвяне на мъртви митрор. на основание 33А</p>	<p>50</p>	<p>St. Jude Medical</p>	<p>САЩ</p>	<p>1 бр. в кутия+1 бр. в кутия+1 бр. в кутия</p> <p>Endurity Core DR2152 + Tendril 2088 58cm. + Tendril 2088 52cm. Стр. 14 и стр. 48</p>

Закотвяне митрор. на основ. на 33А

Замислена митрорна члч
на основание

121

АД

Закотвяне митрор. на основ. на 33А

ВЪРХО С ОРИГИНАЛ

122	интервалите кардиостимулатори VDDR, в комплект с един VDD електрод	предсърдни синхронизация. Алгоритъм за автоматично прекъсване на режими. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция+Биполярен ендокардиален електрод с пасивна фиксация; Прав, изолация от силикон; Разстояние между връх вентрикулен пръстен 15мм; връх-атриален пръстен 130мм; разстояние между атриалните пръстени 11.9 мм; връх,от микропорест титаниев нитрид с обвивка платина-иридий 5мм2; Размер на интродюсера 9F; Пръстен от титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий 32мм2	50	St.Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия+1 бр. в кутия	Endurify Core DR2152 + AV Plus 1368 Стр.14 и стр.24
130	Двукухинни кардиостимулатори VDDR	Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Технология за редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксизмални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. ЯМР съвместим. Позволява частично излагане на ЯМР /2 watts per kg/. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията 9.7 години потвърдена от 5 годишна гаранция	20	St.Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия	Endurify Core DR2152 Стр.14
30	Loop Recorder	Използва се за мониторинг и диагностика на пациенти с ритъмни нарушения. Редимството на тази система е, че това е най - малкото устройство от този тип /12гр/. Има ръчно и автоматично активиране. Три години живот на устройството. При изследване с ЯМР времето на облъчване не трябва да надвишава 60мин	10	St.Jude Medical	САЩ	1 бр. в кутия	Confirm 2102 Стр.28
131	Интродюсери тип Peel Away	Интродюсера се характеризира с добра транзитивност, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 6 F до 12 F, използваема дължина на интродюсера 14 см, максимален диаметър на водача 0.038".	500	St.Jude Medical	САЩ	5 бр. в кутия	Peel Away 4051xx Стр.54

Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на тип на медицинските изделия да се чете и разбира

"или еквивалентно"

Дата 05.06.2

Име и фам

0 - АД

Залитена микрорча
на основател
от 334А

Залитена микрорча
от 334А

Залитена микрорча
от 334А

ОРИГИНАЛА

6